


Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants
Spine

Distribuído por :

MORE
MEDICAL OPERATION RESOURCES FOR EXPERTS

NEURO FRANCE Implants - Fabricante e designer de implantes para cirurgias de coluna

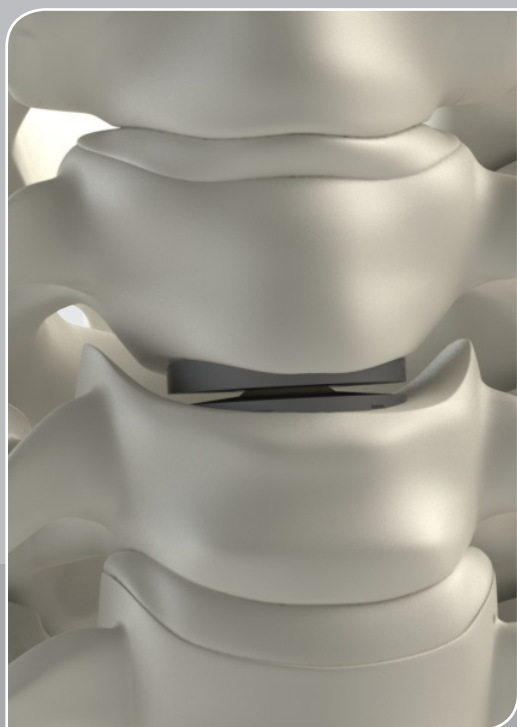

DYNALIS[®]
DISK PROSTHESIS

SISTEMA DE PRÓTESE DE DISCO CERVICAL
EMBALAGEM ESTÉRIL

CE
MARK

ISO
13485 : 2016

NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Phone : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33



Email : neurofrance@neuro-france.net

SISTEMA DYNALIS®

PONTOS PRINCIPAIS :

- Mobilidade 3D sem restrição articular
- Liga de titânio Ti6-Al4-V e PEEK OPTIMA®
- Fixação primária pelas ranhuras anatômicas
- Fixação secundária através de revestimento de titânio de plasma
- Prótese anatômica
- Disco central em PEEK OPTIMA®

PRÓTESE DE DISCO

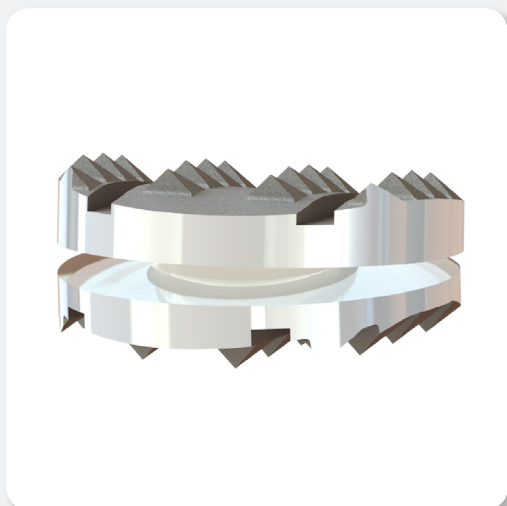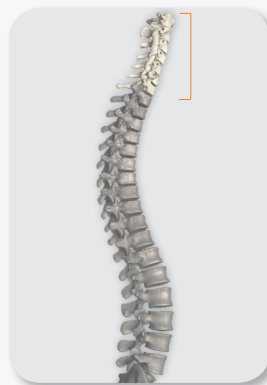

INDICAÇÕES

A placa de disco DYNALIS-C® é destinada ao tratamento de patologias relacionadas à coluna de adultos (máximo de 2 níveis)

Como:

- Radiculopatia
- Mielopatia
- Doença degenerativa do disco


COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

Prótese de disco cervical


Set instrumental

MATÉRIA PRIMA UTILIZADA


Todo sistema DYNALIS-C® é fabricado em liga de titânio Ti6-Al4-V (em conformidade com o padrão ISO 5832/3) e PEEK OPTIMA®.

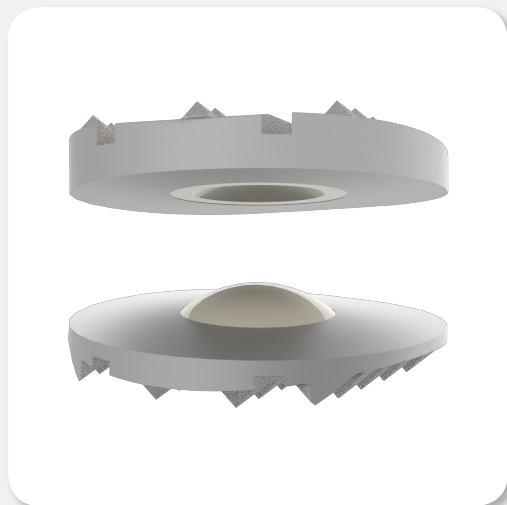

DYNALIS® PRÓTESE DE DISCO CERVICAL




Item n°	Comp. (L)	Comp. (L)	Alt. (H)
681305S	13 mm	L 15 mm	H 5mm
681306S	13 mm	L 15 mm	H 6mm
681307S	13 mm	L 15 mm	H 7mm
681308S	13 mm	L 15 mm	H 8mm
681505S	15 mm	L 17 mm	H 5mm
681506S	15 mm	L 17 mm	H 6mm
681507S	15 mm	L 17 mm	H 7mm
681508S	15 mm	L 17 mm	H 8mm



Todos implantes são fabricados em liga de titânio Ti6-Al4-V (em conformidade com a isso padrão ISO 5832/3) e PEEK OPTIMA®.

Cada prótese é fornecida com um suporte.



DYNALIS® - INSTRUMENTAIS



010930

Suporte para segurador de prótese
DYNALIS-C®



010935

Impactor DYNALIS-C®



012300

Pinça Caspar Distratora (Direito)



012305

Chave Caspar



012312

Pino Caspar L12 (Ti6-Al4-V)



012314

Pino Caspar L14 (Ti6-Al4-V)



012316

Pino Caspar L16 (Ti6-Al4-V)



014103

Iniciador com bloqueio



018611

Prova S - T1



018612

Prova S - T2

DYNALIS® - INSTRUMENTAIS



018613

Prova S - T3



018614

Prova S - T4



018621

Prova L - T1



018622

Prova L - T2



018623

Prova L - T3




018624

Prova L - T4

DYNALIS® - EMBALAGEM

EMBALAGEM PARA IMPLANTES ESTÉREIS

Os implantes estéreis Dynalis-C® são alocados em caixas de 100mm x 150mm

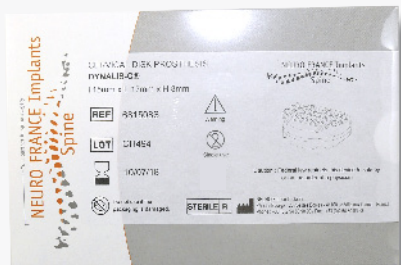

CONTAINER PARA TRANSPORTE

DYNALIS-C® CONTAINER PARA TRANSPORTE DOS INSTRUMENTAIS



Item n° : 000043

↑
SUBSTITUÍDO POR :
↓



Item n° : 0B0814

Your partner in spine surgery

NEURO FRANCE Implants



Spine

www.neuro-france.net

NEURO FRANCE Implants

ZA «le Bourg» - 25 rue des écoles 41160 La Ville aux Clercs - FRANCE

Phone : +33 2 54 80 90 90 - Fax : +33 2 54 80 83 33

Email : neurofrance@neuro-france.net



www.neuro-france.net

Distribuído por :



Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 | sala: 619 - 620
Vila do Golf - Ribeirão Preto SP - Brasil CEP 14027-250